


TOMY 灭菌器使用方法及注意事项

尊敬的用户，您好！


感谢您选择TOMY SX-300/500/700高温灭菌器。为了使您的灭菌器可以正常使用，延长仪器使用寿命，请您可以仔细阅读以下内容。

使用前



固定：确认使用脚轮座以防止使用中的滑移。

检查 LED：
关上灭菌器盖后，LID 标记会消失

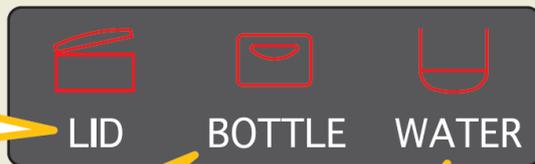

回收瓶内加水：
往回收瓶内加水至超过 LOW 标记，并且没有 BOTTLE 警告

加水：踩下踏板，打开灭菌器盖，加入蒸馏水至略微淹没隔板，之后加入一小杯（100ml 左右）自来水，确认没有 WATER 警告

使用

关闭灭菌器盖，选择使用程序



LIQUID

液体灭菌模式
用于液体的灭菌。
诸如培养基，蒸馏水等




NORMAL

用于固体灭菌，
诸如玻璃器皿，
废弃物等



可选用冷却风扇
(最大 2 级风力)



排气速度调节
(5 级变速)

START

设定灭菌温度和时间，按 START 键开始灭菌


运转中

红色显示表示灭菌锅处于高温高压状态

运转中

橙色显示表示灭菌锅处于高温状态

当灭菌结束时，显示确认压力表表示 0Pa，打开盖子，取出灭菌物




防护盖

压力表

使用后



不定期换水的腔体

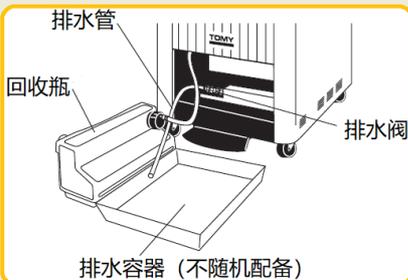

排水容器（不随机配备）

请每周换一次水，保持腔体清洁

- ◆ 打开灭菌器上盖，等待腔体内水温冷却，防止烫伤；
- ◆ 取出置物篮与隔板，并准备好排水容器；
- ◆ 卸下回收瓶，将排水管出口放置于排水容器内；
- ◆ 打开排水阀，等待排水结束；
- ◆ 向腔体内注入自来水，进行冲洗；
- ◆ 关闭排水阀，确认回收瓶内水位；
- ◆ 将回收瓶与隔板放回原位；
- ◆ 向腔体内注入蒸馏水或去离子水至隔板位置，再注入 100ml 左右自来水。

如有任何问题，请与我公司联系，
技术服务热线 400-810-7898，
或登录微信小程序（请扫描右侧二维码）

天美仪拓实验室设备（上海）有限公司

t 400-810-7898
e til-service@techcomp.cn
w www.techcomp.cn

微信报修请扫描二维码使用微信小程序

